

Thopaz+™ Quick Card




Cette Quick Card ne remplace en aucun cas le mode d'emploi REF 200.6841


1. Assemblage



1. Ouvrir l'emballage stérile de la tubulure
2. Conserver le connecteur patient dans son sachet

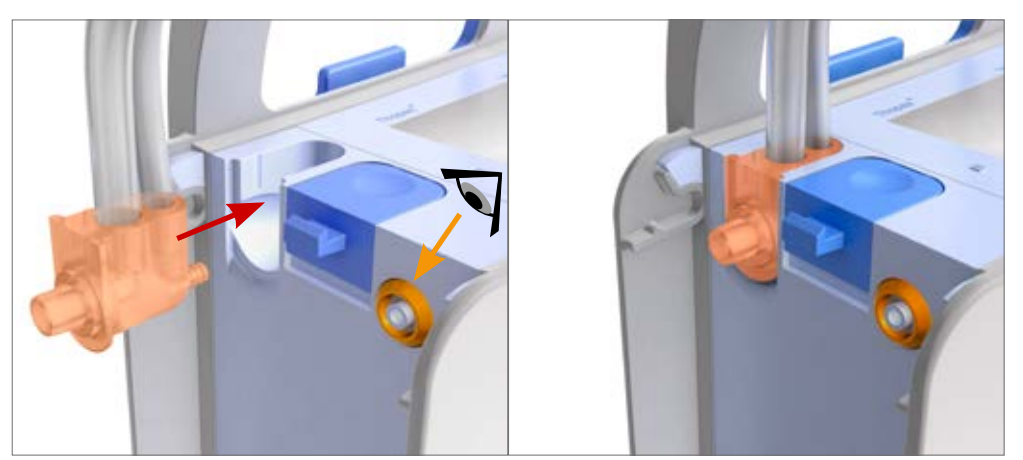

3. Contrôler la présence du joint orange
4. Connecter la tubulure



5. Insérer d'abord la partie inférieure du bocal
6. Enclencher le haut du bocal dan son emplacement



7. Le système Thopaz+ est installé et prêt à fonctionner

2. Mise en marche



1. Allumer Thopaz+
2. Définir si le système est relié à un nouveau patient



3. Vérifier le volume du bocal détecté (détection erronée: jeter le bocal)



4. Thopaz+ est en mode Standby et prêt pour un contrôle du fonctionnement

3. Contrôler le fonctionnement



1. Obturer la tubulure (en gardant une ambiance stérile)



2. Activer la pression




3. Contrôler le volume de la fuite aérienne
Diminution: poursuivre
Augmentation: suivre les instructions du mode d'emploi REF 200.6841




4. Basculer Thopaz+ en mode Standby (maintenir appuyé 3 secondes)
5. Relier Thopaz+ au patient selon les directives de l'hôpital
6. Pour commencer le traitement, appuyer sur «Marche»


4. Modification de la pression pendant le fonctionnement

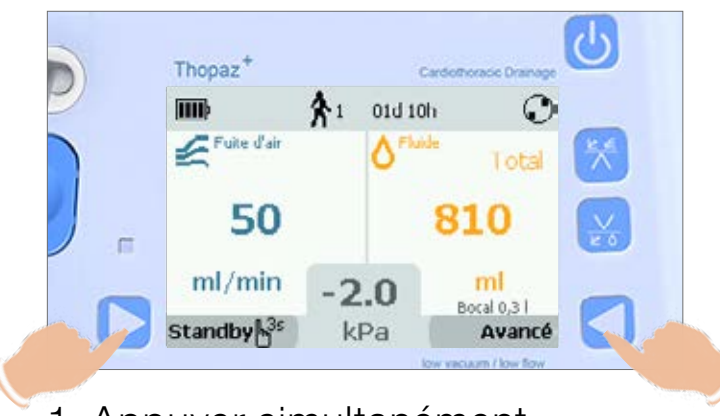

1. Appuyer simultanément

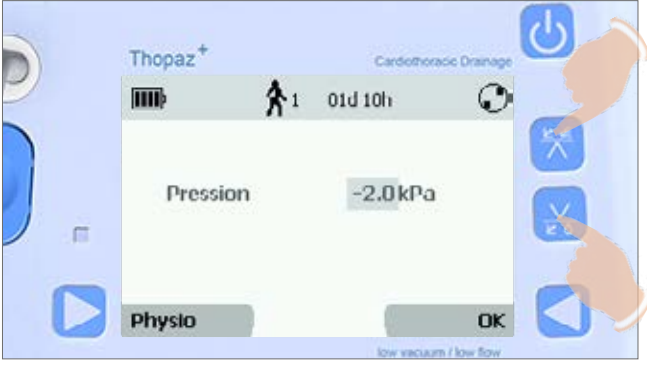


2. Définir la pression souhaitée

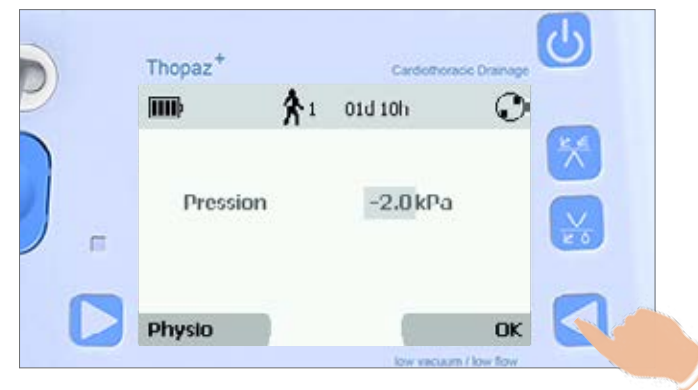

3. Valider en appuyant sur «OK»

5. Évaluation de l'avancement du traitement

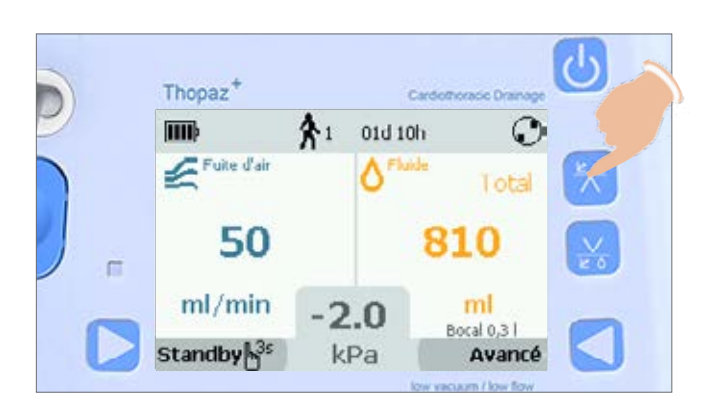


1. Contrôler l'historique de la fuite



2. Appuyer sur «Suivant» pour faire défiler les graphiques représentant la fuite aérienne)




3. Contrôler l'historique du fluide

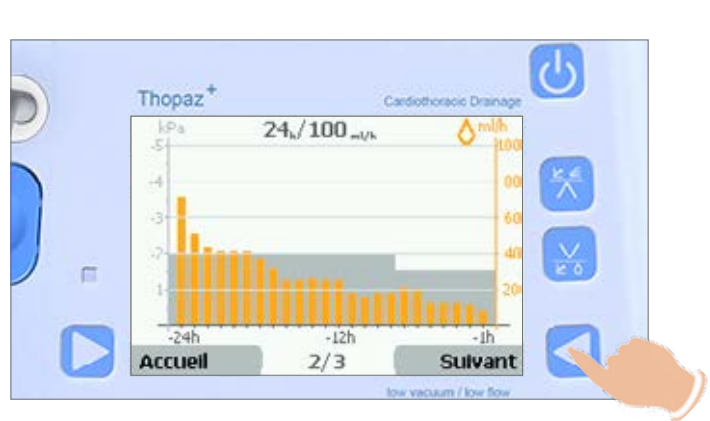

4. Appuyer sur «Suivant» pour faire défiler les graphiques représentant le fluide)



6. Réinitialiser les indicateurs du fluide

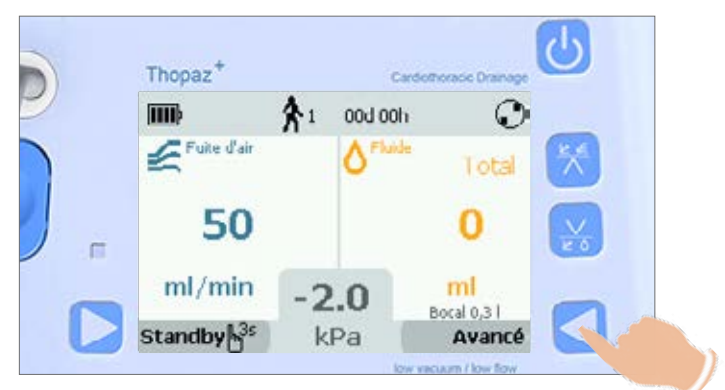

1. Sélectionner le mode d'affichage avancé



2. Sélectionner l'historique du fluide (appuyer pendant 3 secondes)



3. Le premier paramètre du fluide est remis à zéro. Le timer indique la date de la dernière remise à zéro du paramètre. Vous pouvez réinitialiser l'affichage à tout moment en appuyant à nouveau sur la touche historique du fluide (3 secondes).


7. Remplacement du bocal




1. Préparer le bocal stérile
2. Clamper la tubulure




3. Basculer Thopaz+ en mode Standby (maintenir appuyé 3 secondes)

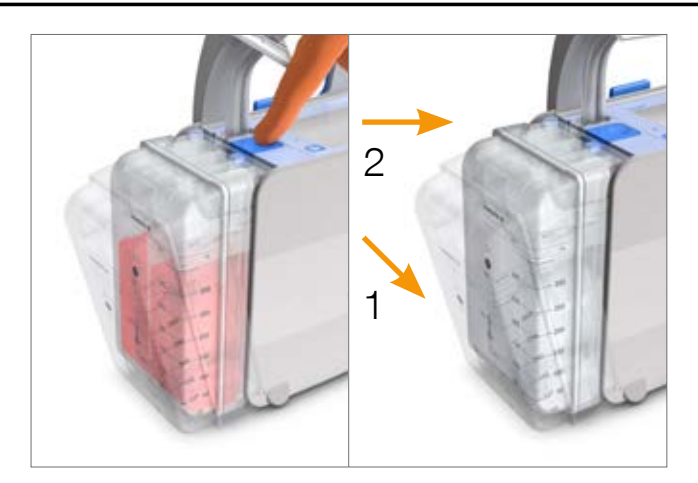


4. Remplacer le bocal

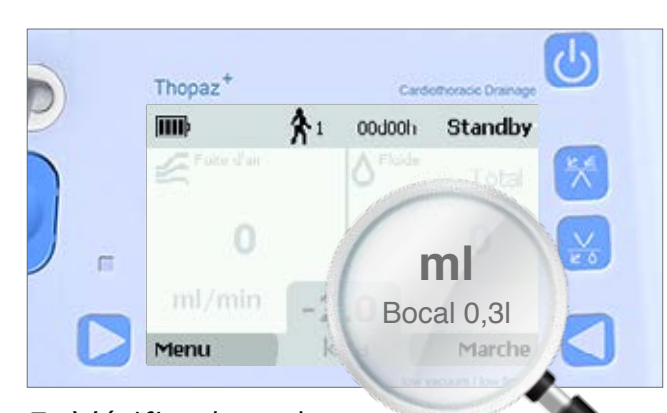

5. Vérifier le volume du bocal détecté (détection erronée: jeter le bocal)

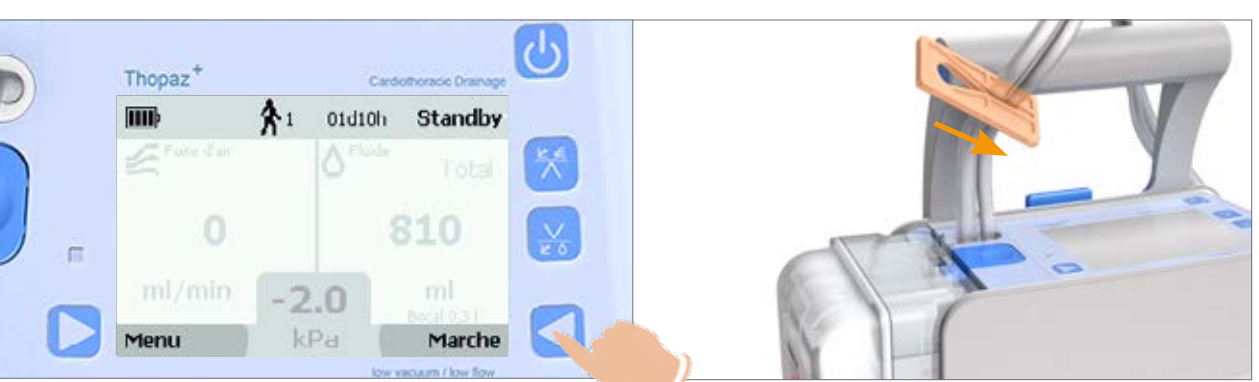

6. Appuyer sur «Marche» et déclampar la tubulure

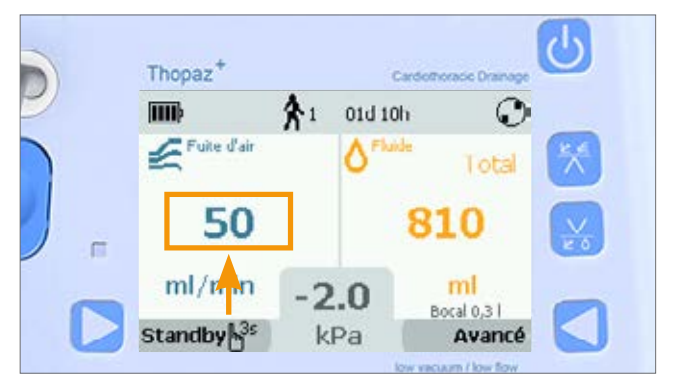

7. Vérifier si la valeur de la fuite aérienne est plausible



8. Fermer hermétiquement le bocal et le jeter selon les directives internes de l'hôpital

8. Alarmes




1. Appuyer simultanément pour éteindre l'alarme




2. Suivre les instructions de l'écran

9. Vérification du drain

⚠ Utiliser uniquement pour les patients dont le drain se trouve dans l'espace pleural.

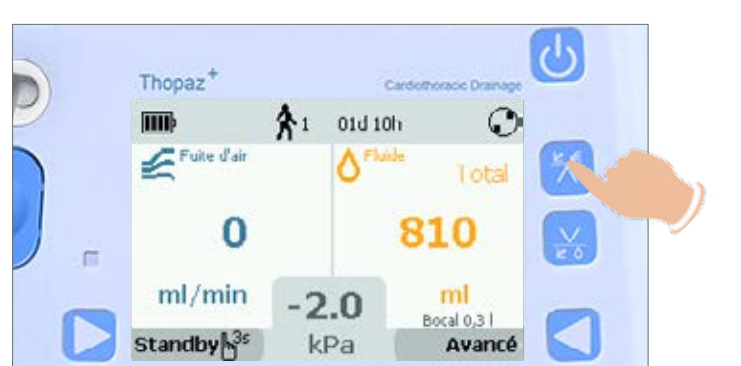

1. Accéder à l'historique de la fuite aérienne
Note: Le contrôle du drain est possible uniquement lorsque la fuite aérienne est nulle. 0 ml/min

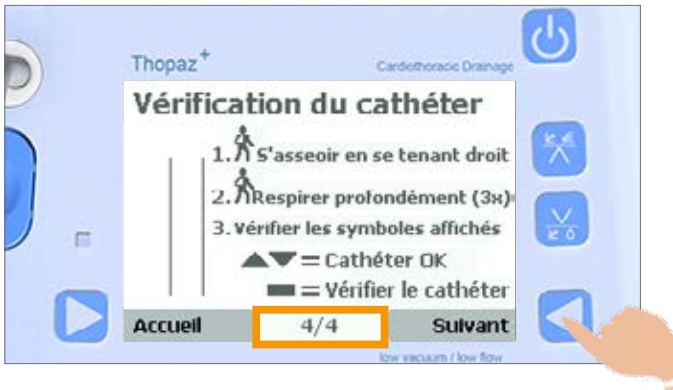


2. Allez à la page 4/4 en appuyant sur «Suivant»
3. Suivre les instructions de l'écran


10. Arrêt du système Thopaz+



1. Clamper le drain
2. Clamper la tubulure

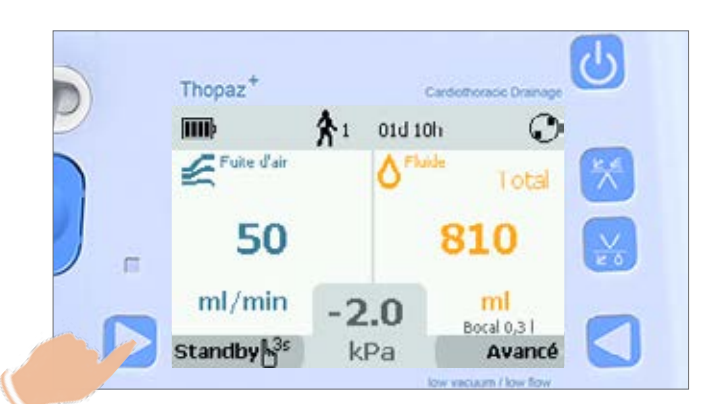

3. Basculer Thopaz+ en mode Standby (maintenir appuyé 3 secondes)

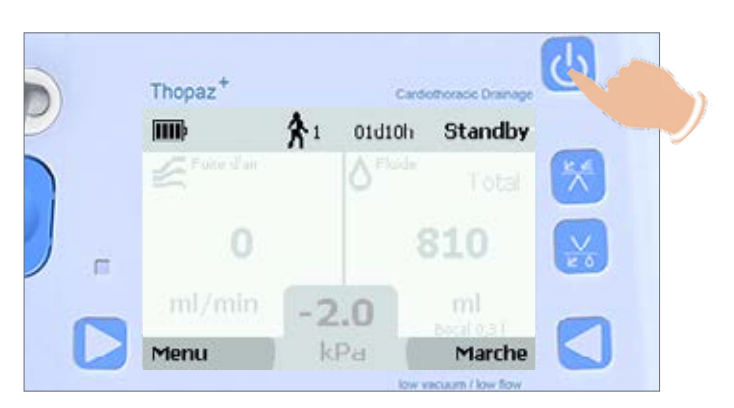

4. Eteindre Thopaz+
5. Retirer le bocal et le fermer hermétiquement
6. Jeter le bocal et la tubulure conformément aux directives internes de l'hôpital
7. Nettoyer et désinfecter Thopaz+ conformément au mode d'emploi REF 200.0681 (consignes générales de nettoyage)



Pour un tutoriel vidéo rapide et facile sur l'utilisation au quotidien en milieu hospitalier, consultez **www.medela-university.com**



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Switzerland
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch

Canada
Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Crescent Unit # 8
Mississauga, Ontario, L5L 0A1
Canada
Phone +1 905 608 7272
Fax +1 905 608 8720
info@medela.ca; www.medela.ca

France
Medela France Sarl
14, rue de la Butte Cordière
91154 Etampes cedex
France
Phone +33 1 69 16 10 30
Fax +33 1 69 16 10 32
info@medela.fr; www.medela.fr

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ,s-Hertogenbosch
The Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl; info@medela.be
www.medela.nl; www.medela.be